



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

*„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”*

Znak pisma: DZP-282-3/2021

Nowa Sól, 17.03.2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na sale cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

**1. Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**2. Dotyczy projektu umowy**

Prosimy o modyfikację §7 ust 1 wzoru umowy na:

*„1. Z tytułu nieterminowej realizacji dostawy przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**3. Dotyczy projektu umowy**

Prosimy o modyfikację §7 ust 3 wzoru umowy na:

*„3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4. Dotyczy projektu umowy**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §11 wzoru umowy w następujący sposób:

*„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materace jednowarstwowe, bezszwowe, antystatyczne, wodoodporne, wykonane z poliuretanu o właściwościach przeciwdrożdżynowych. Odporne na środki dezynfekujące i nie przepuszczające wilgoci?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Materace wykonane z poliuretanu nie wykazują właściwości antyodleżynowych.**

#### **6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 18**

Czy Zamawiający dopuści minimalną wysokość stołu bez materaca 630 mm i maksymalną wysokość 1080 mm.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Do wykonywanych zabiegów niezbędna jest najniższa wysokość blatu poniżej 500mm.**

#### **7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 25**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z blokadą podglówka zwalnianą za pomocą dźwigni z prawej strony?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego, gdyż nie posiada określonej funkcjonalności.**

#### **8. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu o napędzie elektrycznym co pozwoli na uniknięcie w przyszłości dodatkowych kosztów serwisowych związanych z wymianą oleju w napędzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego, gdyż nie posiada określonej funkcjonalności.**

#### **9. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z kołami w obrysie podstawy, widocznymi z zewnątrz. Znacząco ułatwi to czyszczenie kół z wszelkich zabrudzeń.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Użytkownikowi zależy, aby stół posiadał jednolitą podstawę z zabudowanymi kołami, co jest łatwiejsze w utrzymaniu czystości.**

#### **10. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu bez alternatywnego napędu, umożliwiającego regulację wszystkich funkcji stołu. Jest to rozwiązanie rzadko spotykane na rynku i może prowadzić do znacznego ograniczenia konkurencji. Stół, który chcemy zaoferować posiada możliwość zwolnienia blokady hamulców i odjechania w przypadku jakiegokolwiek awarii.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego. Zamawiającemu zależy, aby w przypadku awarii stół miał możliwość zmiany ustawień blatu oraz odblokowania od podłoża poprzez napęd alternatywny. Rozwiązanie tego typu posiada wielu producentów stołów operacyjnych.**

#### **11. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu w którym pozycje flex/reflex osiąga się za pomocą przechyłów blatu i nachylenia sekcji (2 przyciski) bez dedykowanego przycisku. Nie jest to znaczące utrudnienie regulacji a pozwala na bardzo dokładne pozycjonowanie pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **12. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu w którym stan blokady kół sygnalizowany jest przez położenie dźwigni blokady kół (3 pozycje – blokada, odblokowane, jazda na przód).

**Odpowiedź:** **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaga się stołu blokowanego z pilota, nie dźwignią.**

#### **13. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu w którym bezpieczne obciążenie robocze wynosi 250 kg. Jest to niewielka różnica względem opisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **14. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 32, 33**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasów pacjenta ze integrowanymi klamrami, mocowanych z jednej strony za pomocą klamry, a z drugiej za pomocą rzepa. W przypadku sytuacji zagrożenia życia pozwoli to na szybsze odpięcie pacjenta od stołu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

#### **15. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z obudową z wytrzymałego tworzywa. Może to zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem operatora.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

#### **16. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że stół operacyjny powinien mieć bezpieczną dla pacjenta i personelu obudowę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa, nie metalową.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **17. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

W związku, że Zamawiający nie określił wartości regulacji blatu stołu prosimy o potwierdzenie, że wymaga urządzenia o poniższych parametrach:

- przechył Trendelenburga 26°
- przechył anti-Trendelenburga 26°
- przechył boczny stołu lewo/prawo 21°/21°
- regulacja kąta podglówka +45°/-90°
- regulacja kątowa płyty pleców +80°/-40°
- regulacja kątowa płyt podnóżka +20°/-90°
- regulacja kątowa płyt podnóżków na boki 180°

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wartości regulacji blatu stołu i wprowadza zmianę do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.**

#### **18. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z sygnalizacją na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym- na kolumnie:

- Naładowania akumulatorów,
- Włączonego zasilania,
- Stanu technicznego stołu operacyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga , aby na pilocie była informacja o stanie blokady kół.

#### **19. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z minimalną wysokością bez materaca 660 mm – wysokość umożliwiającą wykonanie wszystkich zabiegów operacyjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Do wykonywanych zabiegów niezbędna jest najniższa wysokość blatu poniżej 500 mm.

#### **20. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym akumulator pozwala – w zależności od wykonywanych operacji, obciążeń i częstotliwości zmiany ustawień blatu – na pracę stołu przez około 7 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego.

#### **21. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 5**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z materacami zdejmowanymi przeciwdrożdżynowymi, odciążającymi kręgosłup, wykonanymi z dwuwarstwowej miękkiej pianki poliuretanowej pokrytej antystatycznym materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące, łączonym techniką szwów szczelnych ukrytych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **22. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 8**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny, w którym szyny boczne oraz osłony kolumny wykonane są ze stali niklowo chromowej. Uzasadnienie: Obecny zapis w opisie przedmiotu zamówienia jest nieprecyzyjny, bowiem wymóg „kolumna stołu wykonana ze stali niklowo chromowej” sugeruje, że wszystkie elementy kolumny, także wewnętrzne muszą być wykonane z tegoż materiału, co jest nierealne (np. siłowniki, przekładnie, mechanizmy suwne itp.).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **23. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 11**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w napęd alternatywny umożliwiający regulację większości funkcji stołu, gwarantujący pracę stołu w przypadku awarii, jednak minimalne napięcie jest wymagane dla aktywacji danej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego. Zamawiający wymaga, aby napęd alternatywny umożliwiał regulację wszystkich funkcji stołu.

#### **24. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 14**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym pilot posiada sygnalizację LED zasilania sieciowego, stanu naładowania baterii, statusu ładowania, centralnego położenia blatu? Panel sterowania na kolumnie nie posiada sygnalizacji statusów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaga się stołu blokowanego z pilota, nie dźwignią.

#### **25. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 18**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu (bez materaca) w zakresie 530 – 1010 mm? Parametr dolny odbiega zaledwie o 30 mm od wymaganego, natomiast parametr górny jest lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Do wykonywanych zabiegów niezbędna jest najniższa wysokość blatu poniżej 500 mm.**


#### **26. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 25**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z blokadą podglówka zwalnianą za pomocą dźwigni na niemal całej szerokości podglówka, co pozwala w łatwy sposób zmienić położenie podglówka z trzech stron stołu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego.**

#### **27. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z kołami niezabudowanymi w podstawie stołu?

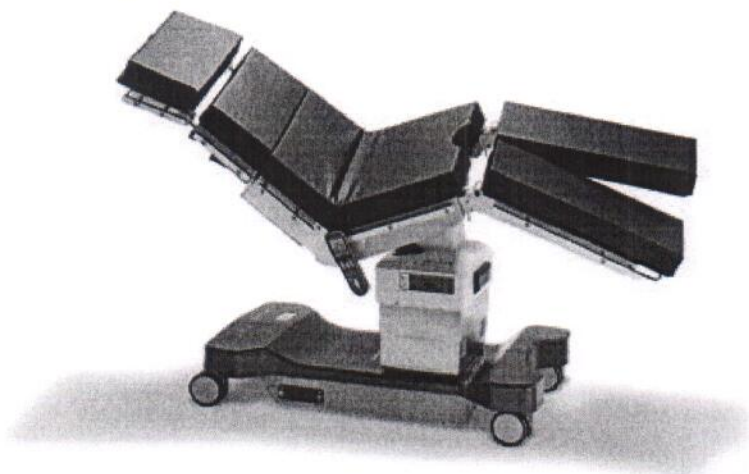

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Użytkownikowi zależy, aby stół posiada jednolitą podstawę z zabudowanymi kołami.**

#### **28. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt.18**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o minimalnej wysokości 622mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Do wykonywanych zabiegów niezbędna jest najniższa wysokość blatu poniżej 500 mm.**

#### **29. Dotyczy projektu umowy**

Prosimy o obniżenie kar w par. 7, pkt 1 – do 0,5%, w par. 7, pkt 3 – do 10%.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę do projektu umowy obniżenia kary w par. 7, pkt.1 , natomiast nie wyraża zgody na zmianę kary w par. 7 pkt. 3.**

#### **30. Dotyczy treści zaproszenia**

Prosimy o umożliwienie złożenia oferty np. mailem z podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **31. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego zgodnie z parametrami poniżej :

Lp.	Opis	Wymogi graniczne  TAK	Odpowiedź Wykonawcy  TAK/NIE  Opisać
1.	Napęd stołu elektrohydrauliczny.		
2.	Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami. Koła o średnicy min. 125 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta		
3.	Ładowarka/moduł zasilający zewnętrzny.		
4.	Akumulator pozwalający na przybliżony czas pracy minimum 100 ruchów stołem		
5.	Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki z "pamięcią" kształtu, odcinane, odporne na środki dezynfekujące.		
6.	Płyta stołu przezierna dla promieni RTG z możliwością swobodnej współpracy z ramieniem C.		
7.	Stół wyposażony w przesuw wzdłużny.		
8.	Szyny nierdzewne o wymiarach 25x10 mm, wzdłuż osi długiej blatu stołu , sekcji nóg oraz sekcji głowy w osi krótkiej stołu.		
9.	Dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie, pilot zdalnego sterowania.		
10.	Możliwość sterowanie awaryjnego funkcjami stołu w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu		
11.	Stół wyposażony w alternatywny napęd hydrauliczny umożliwiający regulację wszystkich funkcji stołu, gwarantujący pracę stołu w przypadku awarii, braku prądu lub rozładowania akumulatora.		
12.	Regulacja za pomocą pilota następujących funkcji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• włączanie/wyłączanie</li> <li>• obniżenie stołu,</li> <li>• uniesienie stołu</li> <li>• przesunięcie wzdłużne</li> <li>• nachylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga)</li> <li>• nachylenie boczne</li> </ul>		
13.	Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane przy pomocy dwóch przycisków <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozycja Flex</li> <li>• pozycja Re-flex</li> </ul> oraz przy pomocy jednego przycisku <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozycja „0”</li> </ul>		
14.	Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu		

	sterującym na kolumnie: - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Pozycji odwróconej		
15.	Blat złożony z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podglówek z regulacją</li> <li>• płyta plecowa</li> <li>• płyta siedziska z wycięciem ginekologicznym lub bez do wyboru przez zamawiającego</li> <li>• podnóżki dzielone para</li> </ul>		
16.	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących		
17.	Możliwość zamiany płyty podglówka z płytami podnóżków		
18.	Wymiar stołu: - akres regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min. 780 do 1050 cm		
19.	Możliwość uzyskanie znacznego wychylenia blatu w celu monitorowania ramieniem „C”.		
20.	Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny $\geq 250$ kg		
21.	Przechyl Trendelenburga.		
22.	Przechyl anti-Trendelenburga.		
23.	Przechyl boczny stołu w lewo/prawo.		
24.	Regulacja kątowa podglówka góra/dół		
25.	Podglówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podglówka w zakresie min. $-45^{\circ}/+30^{\circ}$ . Blokada przy pomocy jednej ręki.		
26.	Regulacja kątowa płyty pleców		
27.	Regulacja kątowa płyt podnóżka		
28.	Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki.		
29.	<b>Wyposażenie :</b>		
30.	Podpora pod rękę ruchoma w dwóch płaszczyznach (góra/dół, na boki) z uchwytami	2 szt.	
31.	Ekran anesteziologiczny z uchwytem do szyny	1 szt.	
32.	Pas pacjenta regulowany	2 szt.	
33.	Klamry pasa pacjenta	4 szt.	
34.	Misa ginekologiczna z uchwytem do szyny	1 szt.	
35.	Wózek na akcesoria	1 szt.	
36.	Pilot przewodowy	1 szt.	
37.	Podpory kończyn dolnych typu GOEPEL wraz z zaciskiem mocującym – para	2 szt.	

**Odpowiedź:** Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, ponieważ nie stanowi ono wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert tylko stanowi przedłożenie przez Wykonawcę nowego opisu przedmiotu zamówienia.

### **32. Dotyczy treści zaproszenia**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie doszło do pomyłki i celowo dzień składania ofert różni się od dnia otwarcia ofert? Do której godziny Wykonawca ma dostarczyć ofertę w dniu składania ofert?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że nie doszło do pomyłki. Dzień składania ofert różni się od dnia otwarcia ofert.

### **33. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 5**

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił wymaganej grubości materaca, proszę o informację, czy Wykonawca ma zaoferować materac o grubości 60 czy 80mm? Jeżeli Zamawiający oczekuje innej grubości, to wnioskuję o dopuszczenie stołu z matercem 60 lub 80mm. – dotyczy l.p. 5

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowaną grubość 80 mm przy zachowaniu pozostałych wymagań dotyczących materacy.

### **34. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 7**

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił wymaganego zakresu regulacji przesuwu wzdłużnego, czy dopuści przesuw regulowany elektrohydraulicznie 420mm? – dotyczy l.p. 7

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **35. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, z sygnalizacją na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie: sieciowego zasilania, naładowania akumulatorów, włączonego zasilania ale bez sygnalizacji stanu blokady kół? – dotyczy l.p. 14

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaga się stołu blokowanego z pilota, nie dźwignią.

### **36. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości (bez materaca) w zakresie 665/1065mm? Oferowane parametry są bardzo dobre i pozwalają na szerokie spectrum wszelkiego rodzaju zabiegów z zakresu ginekologii. – dotyczy l.p. 18

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Do wykonywanych zabiegów niezbędna jest najniższa wysokość blatu poniżej 500 mm.

### **37. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 21-24, pkt. 26-28**

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił zakresów regulacji poniższych parametrów, proszę o dopuszczenie stołu w z następującymi bardzo dobrymi zakresami (dotyczy l.p. 21-24, 26-28):

- Przechył Trendelenburga/Przechył anti-Trendelenburga +-40 stopni
- Przechył boczny stołu w lewo/prawo +-30 stopni
- Regulacja kątowna podglówka góra/dół +- 45 stopni
- Regulacja kątowna płyty pleców +85/-45 stopni
- Regulacja kątowna płyt podnóżka +20/-90 stopni
- Regulacja kątowna płyt podnóżków na boki 0-180stopni

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowane zakresy regulacji powyższy parametrów, z wyjątkiem regulacji kąta podglówka, który ma się opuszczać do -90 stopni.



### 38. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił poniższych parametrów, proszę o dopuszczenie stołu o wymiarach:

- długość 2100 mm
- szerokość blatu (materaca) bez szyn akcesoryjnych - 500 mm
- szerokość blatu z szynami akcesoryjnymi – 560mm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### 39. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym blokada podglówka zwalniana jest za pomocą dźwigni umieszczonych po bokach stołu? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż zwolnienie dwóch dźwigni eliminuje przypadkowe niekontrolowane zmiany w położeniu tego segmentu, co gwarantuje bezpieczne pozycjonowanie głowy pacjenta? – dotyczy l.p. 25

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego, gdyż nie posiada określonej funkcjonalności.**

### 40. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 32

Czy pod pojęciem „pas pacjenta”, Zamawiający rozumie pas tułowia, czy również inne pasy? Jakież – dotyczy l.p. 32

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli pas umożliwiający przytrzymanie pacjenta na wysokości tułowia oraz nóg pacjenta.**

### 41. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 34

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z misą ginekologiczną dokowaną w gniazdach podnóżków po ich odjęciu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
SP ZOZ w Nowej Soli

*Justyna Koszał*

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7  
REGON 970774733  
NIP 925-17-23-350  
[www.szpital-nowasol.pl](http://www.szpital-nowasol.pl)

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. centrala 068 38 82 100  
tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345  
faks 068 387 78 51, 068 38 77 003  
[sekretariat@szpital-nowasol.pl](mailto:sekretariat@szpital-nowasol.pl)