



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W NOWEJ SOLI**

*„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”*

Nowa Sól, dnia 22.10.2020r.

Znak sprawy : DZP-280-56/2020

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Działu Noworodków i Wcześnieaków Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli**” .

**1. Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak.**

**Dotyczy pakietu nr 2**

**2. pozycja 1, 2, 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 1 pozycja nr 1, 2 oraz 3. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**3. pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści opaski ( uprząże) do generatorów oddechów CPAP IF posiadające rzepy, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można dokonać ewentualnej repozycji opaski na głowce w celu wykonania, na przykład wkłucia. Dodatkową zaletą opaski zaoferowanej przez nas jest fakt, iż dzięki odkrytej powierzchni głowy można prowadzić fototerapię, gdzie głowa noworodka jest tą częścią ciała, która najlepiej i najskuteczniej chłonie fale ultrafioletowe w celu eliminacji bilirubiny podczas fototerapii.

Uprząże w rozmiarach:


- 18-22 cm, XS
- 22-26 cm, S
- 26-30 cm, M
- 30-36 cm, L
- 36-42 cm, XL

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Lub**

Czapeczki noworodkowe do mocowania układu pacjenta w rozmiarach: od 000 – 9 ( do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego ). Czapeczka wykonana z bawełny, rozmiar oznaczony kolorem, wyposażona w zapięcia typu rzep do mocowania węży generatora,

8

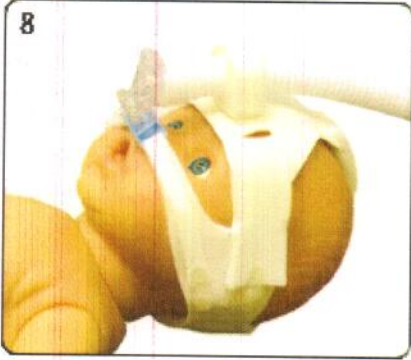

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. **pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści Łącznik do funkcji nCPAP kompatybilny z respiratorem na oddziale (Fabian), o długości 60 cm – łączący aparat z nawilżaczem ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**5. Pytanie nr 4 pozycja 9 oraz 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 9 oraz 10 w zadaniu nr 2, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**6. do pakietu 2**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 30,32,33 do osobnego pakietu. oraz w przypadku wydzielenia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie

w pozycji 24 układów o poniższych parametrach:

UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 110 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności produktu. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA

GENERATOR - wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający dwa kanały oddechowe, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przezroczystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprząży), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bisfenolu,

- wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,

- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,

- wąż łączący aparat z nawilżaczem o  $\varnothing$  wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm,

- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą.

W pozycji 25

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.



Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.

W pozycji 26

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 110 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności produktu. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA

W pozycji 29

Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, końcówki zapinane na rzepy. Dostępnych jest sześć rozmiarów mocowania. Mocowanie generatora wykonane z bardzo elastycznego materiału, służące do stabilnego umocowania na główce, wykonane ze specjalnego materiału przeciwoleźynowego. Czyste biologiczne. W rozmiarach XS, S, SM, M, L, XL. Pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 7. do pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1 okularki do fototerapii

W przypadku wydzielenia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające **dwa niezależne punkty regulacji**, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy przedmiotu zamówienia**

### 8. Pakiet 2 Poz. 24

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie układu oddechowego noworodkowego z generatorem, jednorazowego użytku, przystosowanego do nawilżacza F&P MR850 bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra

**W skład zestawu wchodzi :**

-odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, Ø wew.10mm



- odcinek wydechowy niepodgrzewany
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,4m
- końcówka donosowa rozm. : S,M,L
- odcinek pomiarowy dł 1,6m
- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 9. Pakiet 2 Poz. 25

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie układu oddechowego noworodkowego z komorą nawilżacza, przystosowanego do nawilżacza F&P MR850 bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra, przekrój rur - 10mm, przepływ gazów powyżej 4l/min .

W skład zestawu wchodzi :

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m,
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną
- odcinek przedłużający do inkubatora 0,4m
- dren ciśnieniowy
- łącznik kolankowy 22F-22M
- komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym (osobno pakowana)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 10. Pakiet 2 Poz. 26

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie układu oddechowego noworodkowego z komorą nawilżacza, przystosowanego do nawilżacza F&P MR850 bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra.

W skład zestawu wchodzi :

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,
- odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,6 m
- odcinek przedłużający do inkubatora 0,4 m
- dren ciśnieniowy
- łącznik 10M-10M
- komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym (osobno pakowana)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 11. Pakiet 2 Poz. 29

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie czapeczek do terapii wymiennych, wykonanych z miękkiej bawełny, odpornej na rozciąganie i deformację, zapewniającej przepuszczalność powietrza, ograniczającej przesuwanie główki pacjenta dzięki doskonałemu dopasowaniu (wiele rozmiarów). Czapeczki posiadają rzepy do mocowania, które umożliwiają umiejscowienie interfejsu pacjenta w różnych pozycjach, co stanowi zabezpieczenie przed jednostajnym uciskiem i umożliwia dostosowanie do kształtu głowy. Rozmiary: 000 (obwód 18 – 20cm) do 9 (obwód 40 – 42cm).

do wyboru zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### 12. Pakiet 2 Poz. 31, 32, 33

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji 31, 32, 33 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:**

13. Prosimy o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy na: „Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

- 1) w wysokości 10% wartości niewykorzystanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- 2) w wysokości 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §1 ust. 2 umowy.
- 3) w wysokości 0,1% wartości wadliwego asortymentu za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionego asortymentu wolnego od wad w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 6 umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 5 wzoru umowy na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §9 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 3 na: „Oprócz przypadków określonych w ust. 1 Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- a) co najmniej trzykrotnie wystąpi zwłoka w wykonaniu zamówienia częściowego, albo
- b) zwłoka w wykonaniu Zamówień częściowych przekracza łącznie 30 dni, albo
- c) co najmniej trzykrotnie Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy wolnego od wad lub nie uzupełni stwierdzonych przez Zamawiającego braków w realizacji złożonego zamówienia, w terminie o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

17. Zwracamy się z prośbą o dodanie do §3 ust. 4 oraz §8 ust. 2 pkt. 2.6 zastrzeżenia o treści: „ale o max. 6 miesięcy”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacji i Obsługi Klinicznych  
Wielospecjalistyczny Szpital  
SP ZOZ im. Piłsudskiego  
Justyna Marzula

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7  
REGON 970774733  
NIP 925-17-23-350  
[www.szpital-nowasol.pl](http://www.szpital-nowasol.pl)

tel. centrala 068 38 82 100  
tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345  
faks 068 387 78 51, 068 38 77 003  
[sekretariat@szpital-nowasol.pl](mailto:sekretariat@szpital-nowasol.pl)

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego